

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106744 13.06.2025
Alım No : 25/834
Talep Eden Birim : ANESTEZİ KLİNİĞİ
Konu : ANESTEZİ KLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 20.06.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ENTROPY SENSÖR (ANESTEZİ CİH.İÇİN)			100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeyle açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnamesi Ektedir.(1 sayfa)

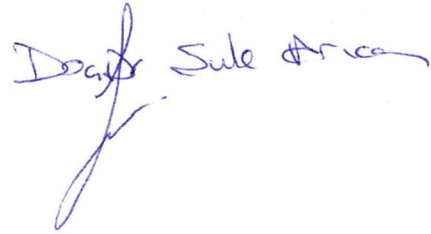
***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**

TH14190 -) ENTROPY SENSÖR (ANESTEZİ CİH. İÇİN) 100 adet

ENTROPY ÖLÇÜM SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sensör tek kullanımlık (disposable) yapıda olmalı ve ameliyathanede mevcut bulunan GE Healthcare marka hastabaşı monitörlerine ait Entropy ölçüm modülü ile birlikte tam uyumlu kullanılabilmelidir.
- 2- Entropy ölçüm sensörü ile hastaya uygulanan anestezi gazlarının belirli etkilerinin monitörize edilmesi, değişik hasta ihtiyaçlarına göre anestezi ilaçların titrasyonlarının oluşturulması ve hastanın hızlı uyandırılması gibi kullanıcıya klinik faydalar sağlayabilmelidir.
- 3- Sensör 2 yaş üzeri pediatrik ve yetişkin hasta gruplarında alın bölgesine yerleştirilebilmeli ve elektrodlar birbirinden bağımsız olarak kullanıcı tarafından hastanın durumuna göre yerleştirilebilmeli, sürekli olarak State Entropy (SE) ile Response Entropy (RE) anestezi derinlik ölçümleri yapılabilmelidir.
- 4- SE ölçümü en az %0 - %91 aralığında, RE ölçümü ise en az %0 ile %100 aralığında yapılabilmelidir.
- 5- Sensörün Entropy ölçümü hata payı en fazla +/-1 değer veya +/-%1 olmalıdır.
- 6- Sensörün altına yerleşiminin kontrolü, Entropy modülü üzerinde hızlı erişim tuşu ile yapılabilmelidir.
- 7- Sensörün raf ömrü en az 12 (oniki) ay olmalıdır


Prof. Dr. Arzu Arıcı
N.E.O. Meram Tıp Fak. Hast.
Anest. ve Rean. A.B.D. Öğrt. Üyesi
Dip. Tes. No: 150678


Doç. Dr. Sule Arıcı