

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 115335
Alım No : : 26/1040
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ
Konu : GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 25.06.2026 10:00

23.06.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SİLİKON YAĞI 10ML (1000 CST)		GZ1156 - 23	20,00	ADET		
2	C3F8 GAZI		GZ1154 - 65	20,00	ADET		
3	VİSKOELASTİK MADDE II (DISPERSİF)		GZ1059 - 34	120,00	ADET		
4	İNTRAOKÜLER LENS TEK PARÇA		GZ1016 - 59	50,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMELER SATIN ALMDAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin dialacaklar tahsil edilecektir.
- 9,**Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimini aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimini suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimini yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.**
- 10,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
- 11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 12,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.



1. SİLİKON YAĞI 1000 CST.

1. Ürün vitreoretinal cerrahide tamponat maddesi olarak kullanılmak üzere Polydimethylsiloxane yapıda olmalıdır.
2. Viskositesi 1000 cst. olmalıdır.
3. Steril cam şırınga içerisinde 10 ml olmalıdır.
4. Kutu içerisinde kullanılan silikonun özelliklerini belirten etiket çıkmalıdır.
5. Ürün ameliyathanemizde kullanılmakta olan cihaza bağlı silikon verme pompası ile birebir uyumlu olmalı, ek ataçman gerektirmemelidir.
6. Teklif verecek firmalar kullanacak hekim talep etmesi halinde, 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
7. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelilerdir.
8. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.
9. Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.

2. C3F8 GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vitreoretinal ameliyatlarda göz içi tamponat olarak kullanılmalıdır.
2. İçeriğinde Octafluoropropane bulunmalı ve saf gaz olmalıdır olmalıdır.
3. Yüksek saflık oranına sahip olmalıdır.
4. Yüksek yüzey gerilimine sahip olmalıdır.
5. Silindir içindeki gaz steril olmamalıdır.
6. Paket edilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
7. Basınç değişimlerine karşı koymak için altı tabakalı kese içeren silindirlerde paketlenmelidir.
8. Silindir içindeki gaz miktarı 75 ml. olmalıdır.
9. Silindir içindeki gaz çok kullanımlı olmalıdır ve bu ürün kutusu üzerinde (etiket şeklinde olmayacak) ürün prospektüsünde orijinal baskı olarak açıkça belirtilmelidir.
10. Ürün kutusu üzerinde uluslararası tek kullanım işareti (Z) varsa ürün çok kullanım olarak kabul edilmeyecektir.
11. -Ürünle beraber ay ayrı steril edilmiş üç adet enjektör seti verilmelidir.
12. Ürün numunesi ihale esnasında gösterilmelidir.
13. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
14. Raf ömrü 24 ay olmalıdır.
15. Pakette önceden monte edilmiş 0.2µm sterilizasyon filtresi, konektör ve 30 G kanülden oluşan şırınga, etiketler ve hasta güvenliği için bileklik bulunmalıdır..
16. Ürün Avrupa standartlarına uygunluğunu gösteren CE sertifikası ve İSO belgesi olmalıdır. CE Belgesi TÜRKAK belgesi olmalıdır.
17. Teklif verecek firmalar kullanacak hekim talep etmesi halinde, 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
18. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelilerdir.
19. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastahane
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115444 / 80325

Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47698

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü. Tıp Fakültesi Hastahane
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 115444 / 80325

Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.

20. Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.

3. VİSKOELASTİK MADDE II (DİSPERSİF)

1. Hidroksipropil metil selüloz oranı %2,4-3,0 arasında (bu sınırlar dahil) olmalıdır. içermelidir.
2. En az 2 ml olmalı, steril(non-pirojenik), cam enjektör içinde olmalıdır.
3. Beraberinde 23 Gkünt uçlu kanülü olmalıdır.
4. Dispersif özellikte olmalıdır.
5. Şeffaf ve akış özelliği iyi olmalıdır.
6. Tüm ön segment ameliyatlarında kullanılmalı ve cerrahi sırasında ön kamara derinliğini korumalıdır.
7. Cerrahi girişim süresince net görüş sağlamalı ve kornea endotelini korumalıdır.
8. Cerrahi girişimlerde ön kamaraya kolayca enjekte edilmeli ve alınabilmelidir.
9. Teklif verecek firmalar kullanacak hekim talep etmesi halinde, 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.
10. Firmalar numune teslim tutanaklarına idareye teslim edilen numunenin markasını, UBB kodunu ve üretim seri numarasını(LOT) belirtmelilerdir.
11. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığına anlaşılması durumunda söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadı olmalıdır.

4. TEK PARÇA (MONOBLOK HİDROFOBİK) LENS

1. Monoblok (tek parçalı) akrilatmetakrilat'tan üretilmiş olmalı asferik optik dizayna sahip olmalıdır.
2. Hidrofobik yapıda optiğe sahip olmalı, Lensin su içeriği %3 den fazla olmamalıdır
3. Lensin Refraktif indeksi 1.47 veya 1.55 veya 1.51 olmalıdır.
4. Lensin optik çapı 6.00 mm ve üzeri, haptik çapı ise 13.00 mm veya 12.50mm olmalıdır.
5. Lens asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır.
6. Lensin Ön kamera derinliği 5.20 veya 5.32 olmalıdır.
7. Lensin A sabiti 118.0 ve 119 arasında olmalıdır.
8. Aşağıdaki üç özellikten biri mutlaka olmalıdır.
 - a) Lens optik materyali Kızıl ötesi ve mavi ışığı filtreleyen Hidrofobik Akrilat/Metakrilat Kopolimer özelliğinde olmalıdır. Tescilli hidrofobik kopolimer formülasyonu sayesinde düşük seviyede yüzey bulanıklığı (surface haze), alt yüzey nano-parlaması (SSNG-subsurface nanoglistenings) ve parlama (glistening) göstermelidir.
 - b) Anterior asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır. ProTec frosted dizayna sahip , Posterior kapsül opasifikasyonunun minimal olması için lensin etrafı 360 derece keskin kenar (Square Edge) özelliğine sahip olmalı ve bu özellik haptik optik birleşiminde de devam etmelidir. Lensin stabilizasyonu için Tri-fix dizayna sahip olmalıdır.
 - c) Lens, Posterior kapsül opasifikasyonunun minimal olması için Amon-Apple 360 derece keskin kenar teknolojisine sahip olmalıdır. Lens, kapsül içinde maksimum stabilizasyon için Anti-Vaulting haptik dizayna sahip olmalıdır.
9. Lensin dioptri üretim skalası +6.00 ile +30.00 diyoptri arasında olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KADIOĞLU
N.E.Ü Tıp Fakültesi Hıfzanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 105144 / 80325

Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.Ü İktisadi İhtisas Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47698

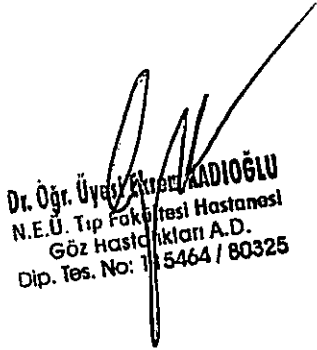
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Mehmet ADAN
N.E.Ü İktisadi İhtisas Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 12248

RECEIVED
JULY 19 1954
U.S. AIR FORCE
WASHINGTON, D.C.


RECEIVED
JULY 19 1954
U.S. AIR FORCE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JULY 19 1954
U.S. AIR FORCE
WASHINGTON, D.C.

10. Sıkışıklık olmaması, lens göz için yerleştirilirken dengeli şekilde açılmalı, kolay maniple edilebilmeli, bag içinde uyumlu şekilde oturmalı, keskin kenar özelliği olmalı, katlanırken enstrüman izi minimal olmalıdır.
11. Lensler preloaded veya smartload sisteme sahip olmalıdır .
12. Lenslerin opaklaşma ve dioptri hatası olduğunda üretici veya temsilci firmanın sorumluluk alacak ve tazmin edecektir.
13. Sterilizasyonu bozulan lenslerde bayi ve distribütör firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
14. Lensin paketi orijinal olup, dış paketin üzerinde lens özelliklerinin yanı sıra üretici firma adresi, üretim lot numarası ve son kullanma tarihi olmalı, steril poşeti üzerinde ise sterilizasyon yöntemi, seri numarası, lensin modeli yazılı olmalıdır.
15. Ürünün UTS kaydı olmalıdır, Teklif veren firmanın bayilik kaydı mutlaka olmalıdır.
16. Malzemenin kullanımı aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığında söz konusu malzeme yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir. Malın kabul edilmiş olması, teknik şartnameye tam uygun malzeme teslim edilmiş olduğu anlamına gelmez.
18. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadı olmalıdır.
19. **Firma teklif verdiği lensin dioptri aralığındaki tüm numaraların UBB'sini ihale dosyasına mutlaka belirtmelidir. İdare bu kalemdeki lensin alımına tek kalemde çıkmış olup, sonradan bölümün mevcut güncel eksik olan dioptri İOL numaraları seçilip mal siparişi 4 ay içinde tamamlanacaktır.**
20. Teklif verecek firmalar kullanacak hekim talep etmesi halinde, 1 adet numune getirecek, gelen numuneler kullanacak hekim tarafından test edilip değerlendirilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KADIOĞLU
N.E.U. Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 11 5464 / 80325


Prof. Dr. Mehmet OKKA
N.E.U. Meram Tıp Fak. Hast.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 35798/47698


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KADIOĞLU
N.E.U. Meram Tıp Fak.
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 11 5464 / 80325

12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11

12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11

12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11
12/11/11