

**T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No : 114595
Alım No : : 26/903
Talep Eden Birim : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ
Konu : ANJİO (HEMODİNAMİ) ÜNİTESİ İÇİN 17 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 02.06.2026 10:00

22.05.2026

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmî Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 2.5X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
2	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 2.5X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
3	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 2.75X10 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
4	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 2.75X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
5	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 2.75X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
6	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3X10 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
7	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
8	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
9	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.25X10 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
10	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.25X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
11	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.25X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
12	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.5X10 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
13	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.5X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
14	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 3.5X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
15	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 4X10 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
16	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 4X15 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		
17	PTCA BALON KATETER ANJİYOPLASTİ 4X20 MM		KR1127 - 266	2,00	ADET		

TEKNİK ŞARTNAMESLER SATIN ALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR. DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
- 4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
- 5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
- 8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan



veya kodu doğru verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı, üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması halinde, oluşacak kurum zararını malzeme faturasüyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi halinde ise yüklenicinin

diyalacaklar tahsil edilecektir. **9, Malzeme teslim eden firmaların Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında olan, tekil takip süreci başlatılmış veya sözleşme süresi boyunca tekil takip süreci başlatılan tıbbi malzemeler için ürün hareket bilgisini (verme bildirimini) idareye her teslimatta yapacaklardır. Muayene ve teslim aşamasında her faturada tıbbi malzemelere ait ürün barkod numarası, lot numarası, varsa seri numarası yer almalı, verme bildirimi aşamasında fatura numarası ile bildirim yapılmalı, irsaliye no ile bildirim yapılmamalıdır. Söz konusu işlemler satın alınan ve kullanım bildirimi suretiyle hastanemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesinde zorunlu olduğundan ÜTS bildirimleri ile ilgili ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin idareye sunulması gerekmekte olup, ÜTS bildirimi yapılmayan veya bu nedenlerle yüklenici firma tarafından yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle hastanemizin zararı söz konusu olursa ilgili yükleniciden tahsilâ yoluna gidilecektir.**


10, Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları (malzeme tanımlayıcı barkod) teslim edilecektir. yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.

11, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.

12, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi malzemelerin TITUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması, tanımlı sat koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle MEDULA ve TITUBB sisteminde uygun olmayan ve tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir. Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir. Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.

NOT:

- 1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYILIK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURDUR.
- 2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
- 3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
- 5-ÖDEMELER; DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE, MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.



KESİCİ ÖZELLİKLİ, KOMPLİYAN OLMAYAN BALONLU DİLATASYON KATETERİ

1.1.Anjiyoplasti için uygun olmalıdır.

1.2.Şaftı tek operatör kullanımına uygun ve 0.014' kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

1.3.Balon materyali 'non-kompliyan' yapıda olmalıdır.

1.4.Balonlu dilatasyon kateteri üzerinde balon ile açılıp kapanan nitinol materyalinden mamul 3 (üç) adet 0.021 mm kalınlığında kesici bıçak olmalı; bu bıçaklar sayesinde balon muntazam bir dilatasyonu sağlamak için, dilatasyonla eş zamanlı kesme işlemi yapmalıdır.

1.5.Bıçaklı, balonlu dilatasyon kateteri, modüler dilatasyon ile (yastıkların bağımsız olarak şişmesiyle) diseksiyon riskini minimize etmeli, 'dog-bone' defekti ortaya çıkarmamalıdır.

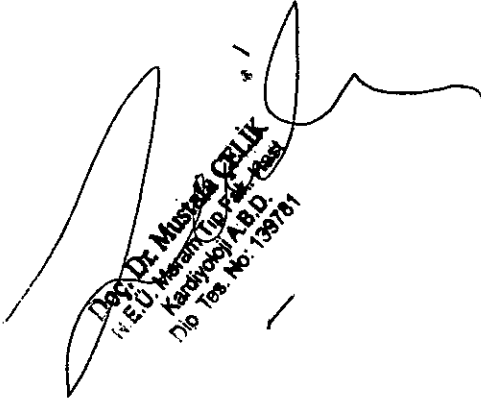
1.6.Balonlu dilatasyon kateter gövdesi (şaftı) tork verilebilir (döndürülebilir) bir yapıda olmalı; bu özelliği sayesinde üstün geçiş avantajı oluşturabilmelidir.


1.7.Balon çapları 1.50, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50 ve 4.00 mm; uzunlukları ise 10,15 ve 20 mm içerisinden seçilebilmelidir.

1.8.Balon, nominal basınca maksimum 10 ATM ulaşmalı; garanti edilen patlama basıncı minimum 20 ATM olmalıdır.

1.9.Balonlu dilatasyon kateterleri distal segmenti hidrofilik kaplama olmalıdır.

1.10.Üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.


Doç. Dr. Mustafa ÇELİK
Izmir U. Mesman (Uz. Fak. Hast.)
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Teş. No: 139781


Doç. Dr. Mehmet Seyfeddin GÜLSÖZ
E. U. Mesman Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.D.
Dip. Teş. No: 154070

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322
UCBAW/STP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/15/01 BY 60322
UCBAW/STP