


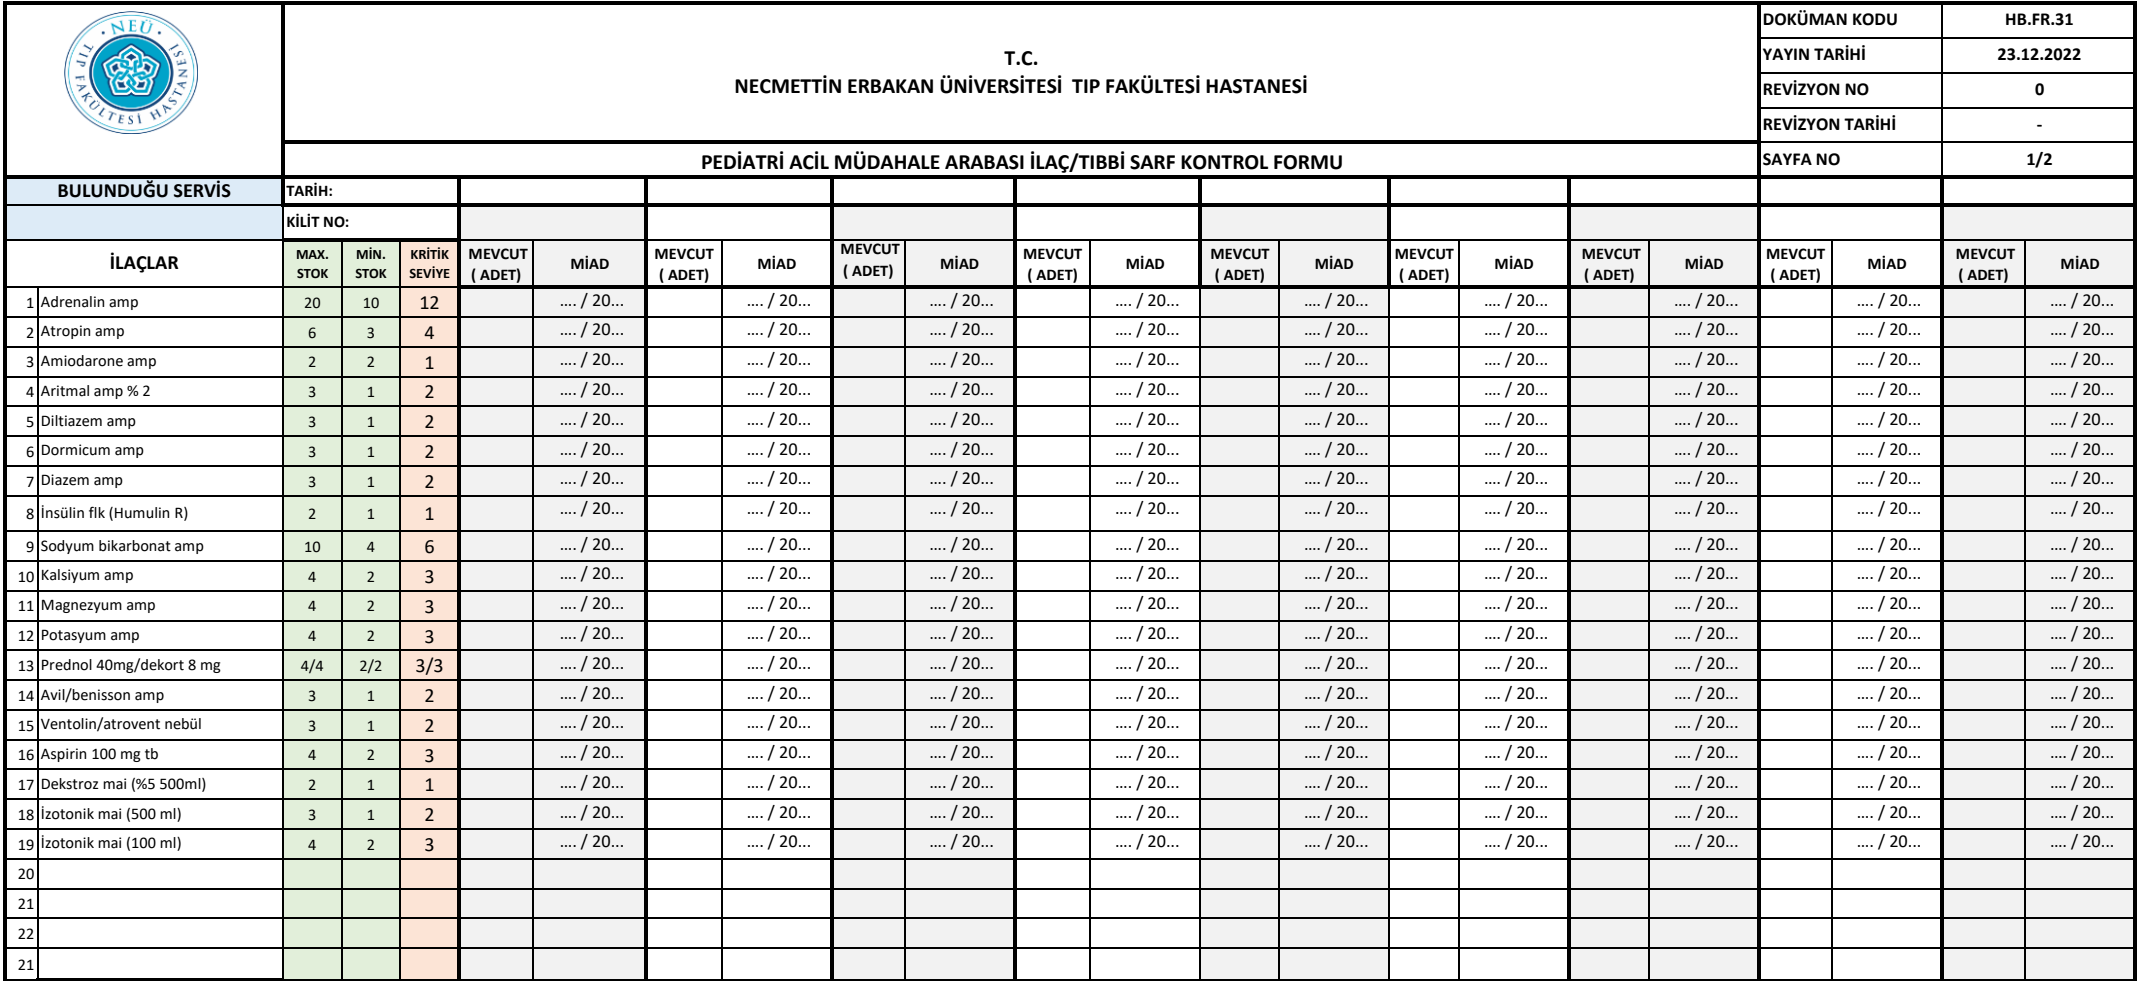

SARF MALZEMLER		GÜNLER																		
		MAX. STOK	MIN. STOK	KRİTİK SEVİYE	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD
1	Steteskop	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
2	Orofaringeal airway	4	2	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
3	Dozimetre	3	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
4	Balonvalvmaske(adult/ ped)	1/1	1/1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
5	Laringoskop	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
6	Yedek pil	4	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
7	Bleyd (adult/ped)	2/2	2/2	2/2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
8	Endotrakeal tüp(her boyuttan en az 1 adet)	10	5	5		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
9	Stile/guide	2	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
10	Oksijen maskesi	2	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
11	Non steril eldiven (kutu)	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
12	Steril eldiven	4	2	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
13	Glikometre	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
14	Pulse oksimetre	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
15	EKG elektrodu	10	4	5		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
16	İntraket/ iv kanüller	10	4	5		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
17	Serum seti	4	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
18	Enjektör	10	5	5		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
19	O2 ara line	2	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
20	Aspirasyon kateter	4	2	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
21	Flaster	2	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
22	Makas	2	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
23	Sargı bezi	2	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
24	Nazogastrik sonda	2	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
25	Foley sonda	2	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
26	Kayganlaştırıcı jel	2	1	2		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
27	Tansiyon aleti	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
28	Defibrilatör	1	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
29	İnsülin enjektörü	2	1	1		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...		 / 20...
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
KONTROL EDEN					AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA	

Listede bulunan ilaç ve sarf malzemelerin kontrolleri ayda bir defa ve kullanıldıkça yapılmalıdır. Narkotik grubu ilaçlar ve soğuk zincire tabi ilaçlar uygun alan ve koşullarda saklanarak kontrolleri yapılmalıdır.