


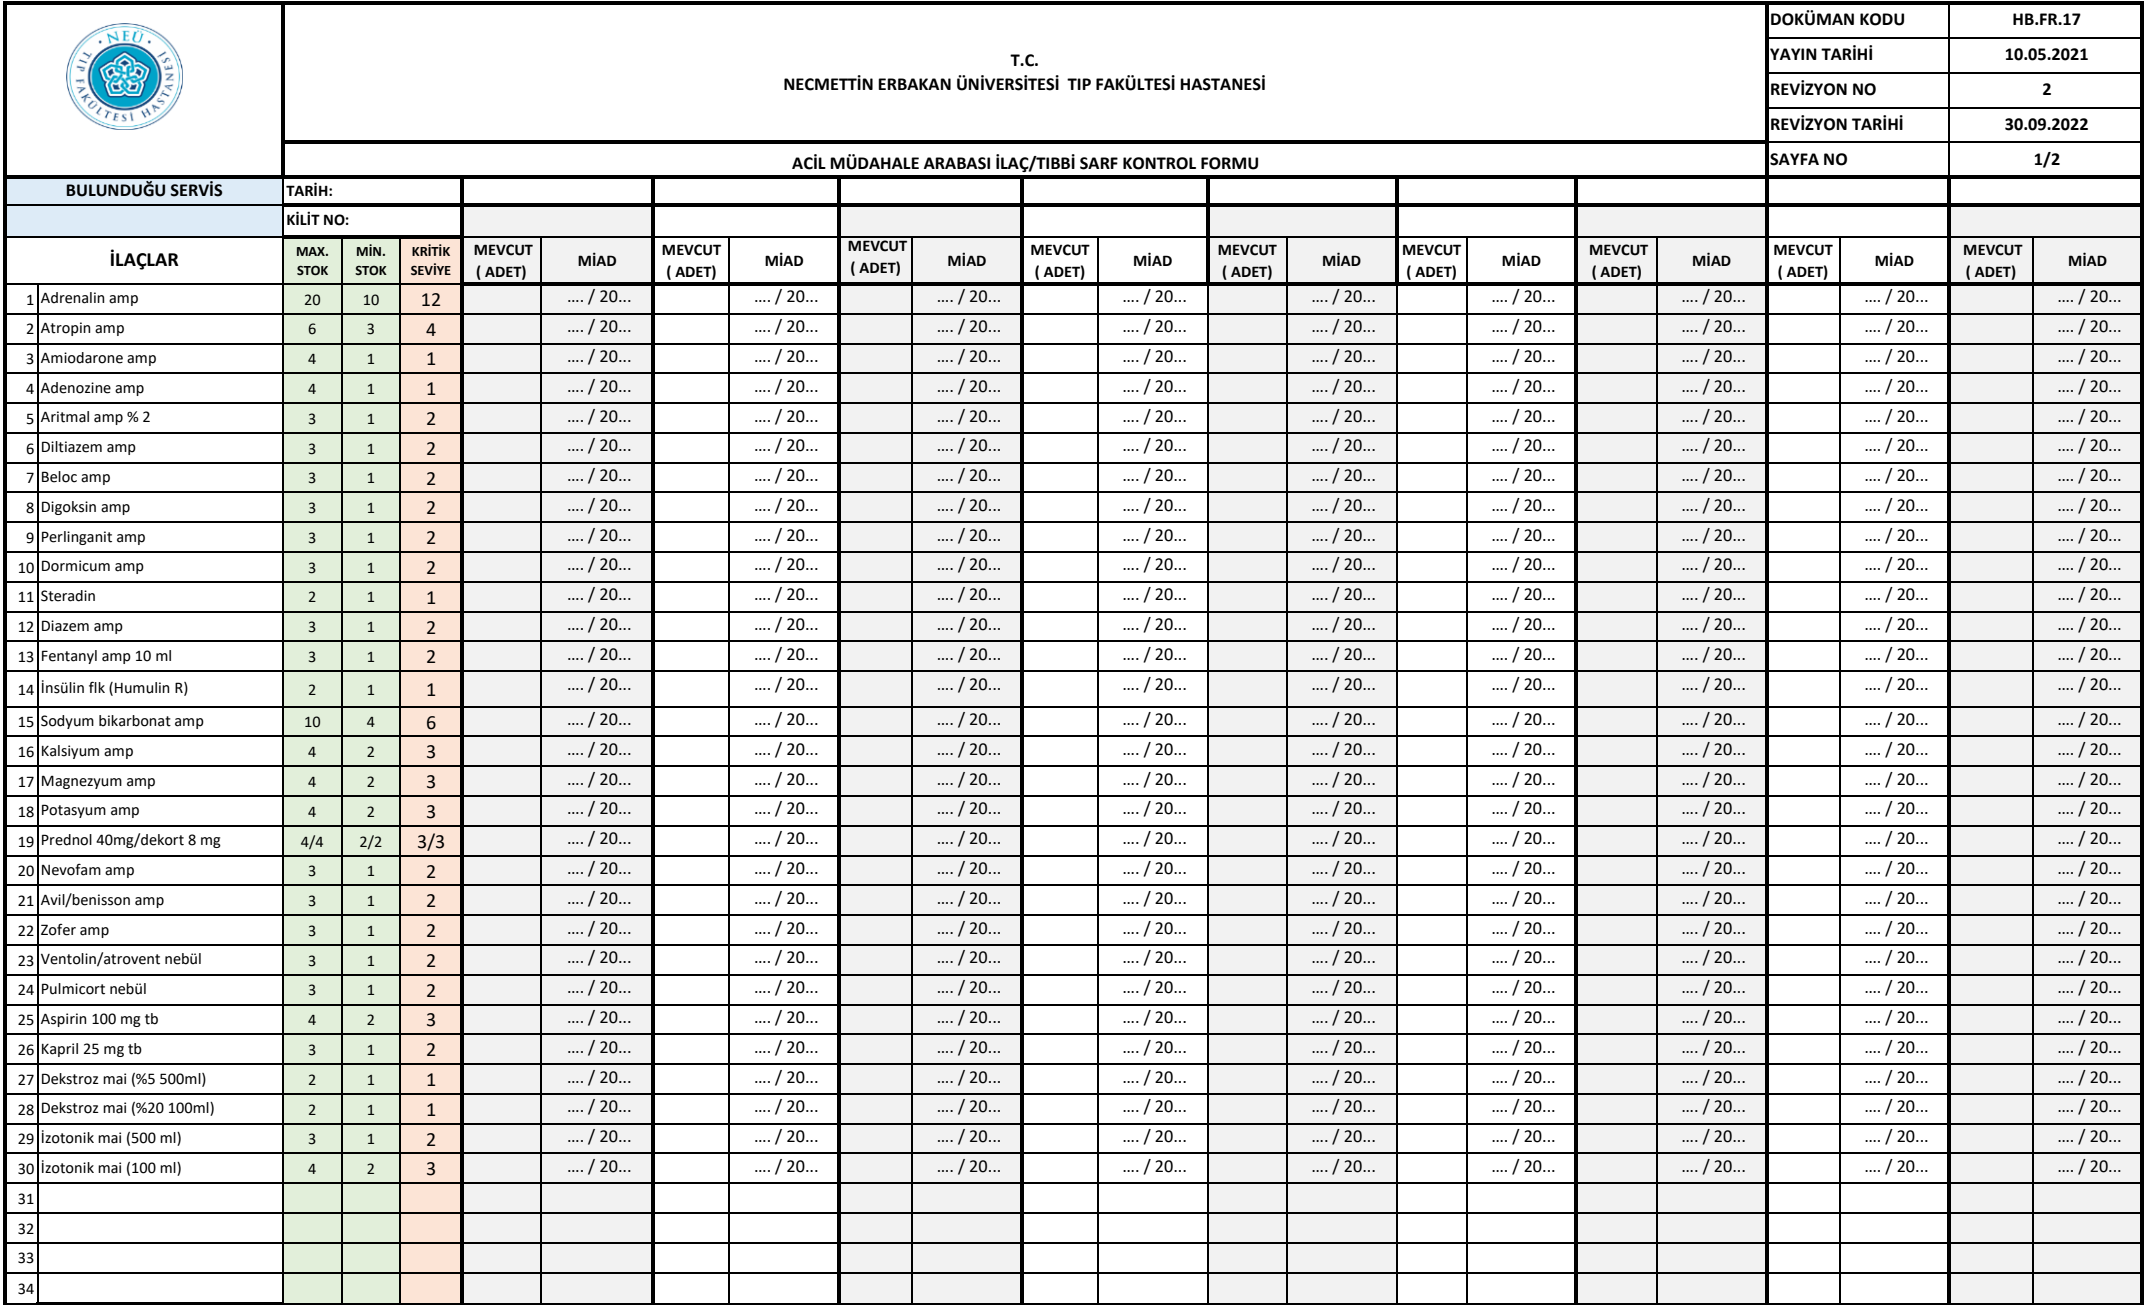

	GÜNLER 																				
SARF MALZEMLER	MAX. STOK	MİN. STOK	KRİTİK SEVİYE	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD	MEVCUT (ADET)	MİAD
1 Steteskop	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
2 Orofaringeal airway	4	2	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
3 Dozimetre	3	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
4 Balonvalvmaske(adult/ ped)	1/1	1/1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
5 Laringoskop	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
6 Yedek pil	4	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
7 Bleyd (adult/ped)	2/2	2/2	2/2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
8 Endotrakeal tüp	10	5	5		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
9 Stile/guide	2	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
10 Oksijen maskesi	2	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
11 Non steril eldiven (kutu)	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
12 Steril eldiven	4	2	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
13 Glikometre	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
14 Pulse oksimetre	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
15 EKG elektrodu	10	4	5		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
16 İntraket/ iv kanüller	10	4	5		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
17 Serum seti	4	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
18 Enjektör	10	5	5		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
19 O2 ara line	2	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
20 Aspirasyon kateter	4	2	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
21 Flaster	2	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
22 Makas	2	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
23 Sargı bezi	2	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
24 Nazogastrik sonda	2	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
25 Foley sonda	2	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
26 Kayganlaştırıcı jel	2	1	2		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
27 Tansiyon aleti	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
28 Defibrilatör	1	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
29 İnsülin enjektörü	2	1	1		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...		... / 20...
30 Kişisel koruyucu ekipman																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
KONTROL EDEN				AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA		AD SOYAD/İMZA	

Listede bulunan ilaç ve sarf malzemelerin kontrolleri ayda bir defa ve kullanıldıkça yapılmalıdır. Narkotik grubu ilaçlar ve soğuk zincire tabi ilaçlar uygun alan ve koşullarda saklanarak kontrolleri yapılmalıdır.